


Achtung: Die Abschirmung ist zum Wegaufnehmer-Gehäuse isoliert.
Für die Schutzerdung des Gehäuses hat der Anwender geeignete Massnahmen zu treffen.

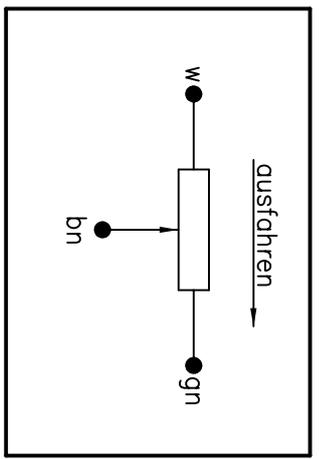

| Pos. | Menge | Z.Nummer: | Material: | Behandlung: |
|---|----------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| Änderungen: | | | | |
| a | Kabel gewechs., 2.97 | b | Kabel 3x0.5mm2, farbcod., 7.04 | c |
| d | | e | | f |
| 28-012 | | | | |
| GENGE & THOMA AG CH-2543 Lengnau/Biel | | Wegaufnehmer (gewickelt) HP 28 | | |
| | | gez.: 02.11.94 DM gepr.: | | Masstab: 1:1 |
| a | b | | | |
| 28-012 | | | | |